

先生各位

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、下記の項目におきまして、検査内容を変更させていただきますのでご案内申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《変更日》 平成 30 年 4 月 2 日（月）受付分より

《変更内容》

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.18	2783	結石分析	検査コード	7222	2783
			検体量	結石 5mg 以上	結石 10mg
			所要日数	4 ~ 7 日	6 ~ 9 日
			検査方法	赤外線吸収スペクトル法	赤外線吸収スペクトロフォトメトリー法


※ その他の検査内容に変更はございません。

《変更理由》 委託先見直しのため

《備考》 添付の報告書イメージをご参照ください。

添付：報告書イメージ

【変更後】

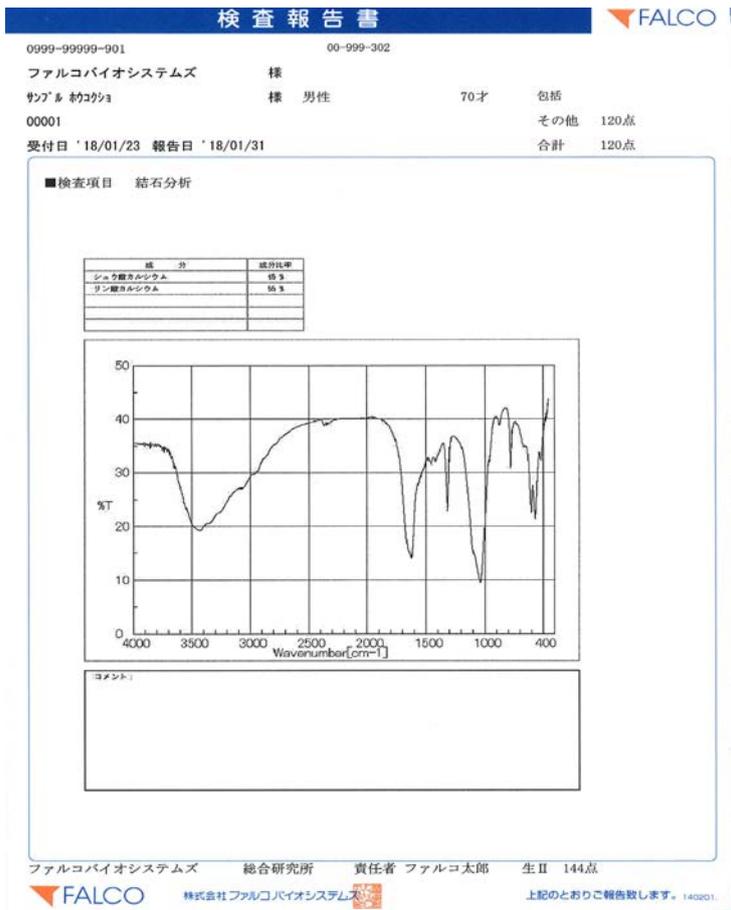

【変更前】

