

先生各位

## 検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、下記の項目におきまして、検査内容を変更させていただきますのでご案内申し上げます。  
今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬白

記

《変更日》 平成 17 年 10 月 17 日(月) 受付分より

《変更内容》


総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.63	3937	ヘリコバクター・ピロリ抗体 血中 IgG	基準値および単位	10 U/ml 未満 陰性	1.7 EV 以下 陰性
			報告単位	整数	少数第一位
			測定試薬	E プレート '栄研' H.ピロリ抗体 (栄研化学株)	デタミナー H.ピロリ抗体 (協和メデックス株)

その他の検査内容に変更はございません。

《変更理由》 現行試薬メーカーからの供給停止に伴う測定試薬の変更

〔 現行と同じく日本人株を用いた試薬ですが、使用抗原が異なるため、基準値、単位、報告形態が変更になります。 〕

《現行試薬との相関》

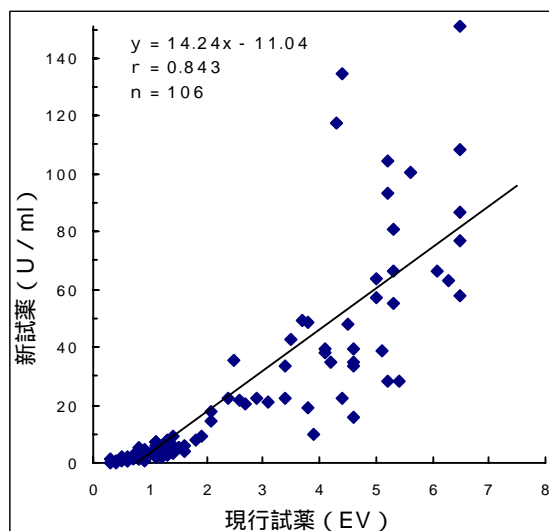

		現行試薬		
		陰性	判定保留	陽性
新試薬	陰性	60	2	1
	陽性	0	2	41

判定一致率：96.2%