

先生各位

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、下記の項目におきまして、検査内容を変更させていただきますのでご案内申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《変更日》 平成 24 年 4 月 2 日(月) 受付分より


《変更内容》

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.87	5528	HCV コア抗原	検査方法	CLIA 法	RIA 固相法 (IRMA)
			基準値	3 fmol/L 未満	20 fmol/L 未満
			備考	検出感度: 3 fmol/L	検出感度: 20 fmol/L

その他の検査内容に変更はございません。

《変更理由》 検査試薬製造中止のため

《相関図》

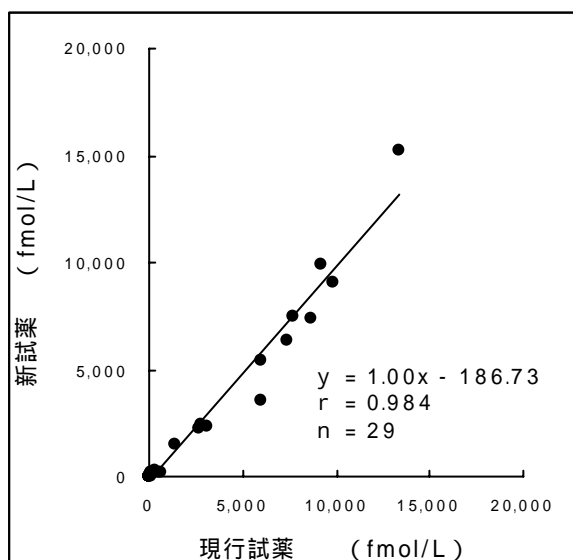

《判定一致率》

一致率 96%	現行試薬			
	陽性	陰性	合計	
新試薬	陽性	29	8 ()	37
	陰性	0	163	163
	合計	29	171	200

() 判定が乖離した 8 例は、リアルタイム PCR 法でウイルスが検出されました。