

先生各位

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、下記の項目におきまして、検査内容を変更させていただきますのでご案内申し上げます。今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《変更日》 平成 26 年 1 月 27 日(月) 受付分より

《変更内容》

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.78	1584	麻疹ウイルス抗体 IgM	測定試薬	下記参照	
P.79	1513	単純ヘルペスウイルス抗体 IgM			


その他の検査内容に変更はございません。

《変更理由》 非特異反応が低減した改良試薬への変更

《相関図》

麻疹ウイルス抗体 IgM


【改良試薬では交差反応による偽陽性が低減】
以前は風疹、伝染性紅斑、突発性発疹、デング熱などによる交差反応が報告されていました。

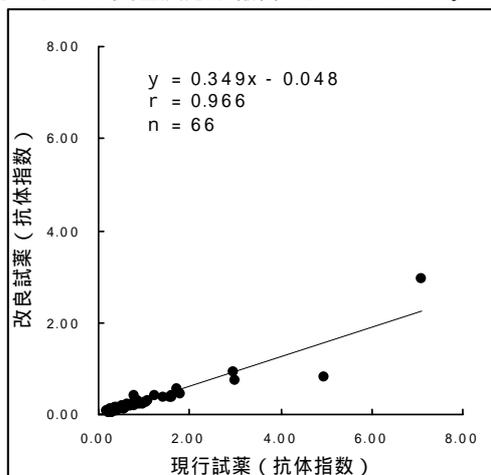

一致率：71.2%	現行試薬			合計	
	-	±	+		
改良試薬	-	46	9	8	63
	±	0	0	2	2
	+	0	0	1	1
合計	46	9	11	66	

単純ヘルペスウイルス抗体 IgM

【改良試薬では判定保留が低減】

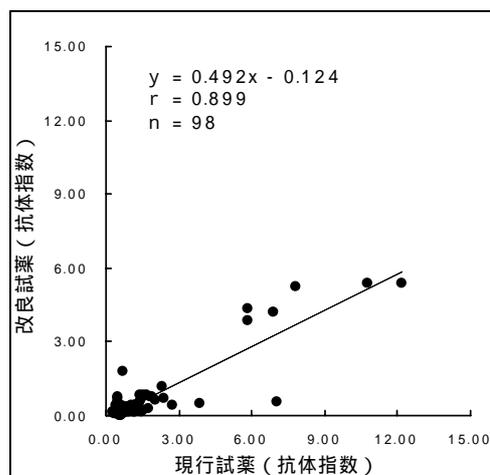

一致率：63.3%	現行試薬			合計	
	-	±	+		
改良試薬	-	56	14	17	87
	±	0	0	4	4
	+	1	0	6	7
合計	57	14	27	98	