

先生各位

ヘモグロビン A_{1c} の標準品の表示値 変更に関するご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、このたびヘモグロビン A_{1c} の試薬メーカー（アークレイ株式会社）より、JCCLS 及び日本糖尿病学会からの要請で標準品の表示値を変更する旨の連絡がありました。それに伴い、変更前後のデータの互換性について下記のとおりご案内申し上げます。


謹白

記

《変更日》 平成 18 年 11 月 20 日（月）受付分より

《対象項目》 ヘモグロビン A_{1c} (HbA_{1c}) HPLC 法 【検査コード：0213】
(総合検査案内 p.8・p.97)

《表示値変更前後の関係》

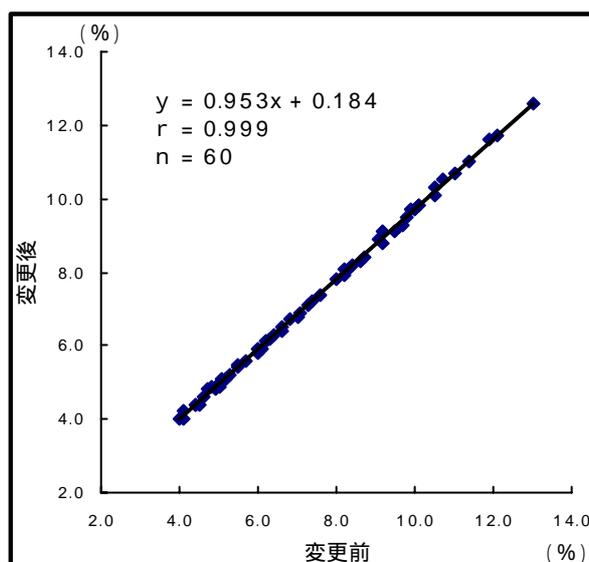

10.0%付近の測定値は 0.2～0.3%程度低くなりますのでご注意ください。
なお、基準値付近の測定値は互換性があるため、基準値は変更いたしません。