

お客様各位

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、下記の項目におきまして、検査内容を変更させていただきますのでご案内申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《変更日》 令和6年4月1日(月)受付分より

《変更内容》


総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.82 P.126	6679	HBV-DNA 定量 アキュジーン	項目名称	HBV-DNA 定量 PCR	HBV-DNA 定量 アキュジーン
P.84 P.126	7062	HCV-RNA 定量 アキュジーン		HCV-RNA 定量 PCR	HCV-RNA 定量 アキュジーン
P.90	1256	CA125 血清	検査方法	CLIA 法	ECLIA 法
			JLAC10	5D100-0000- 023-051-01	5D100-0000- 023-053-01
			基準値	35.0 U/mL 以下	35 U/mL 以下
			報告形態	小数点第1位	整数
			最小報告値	1.1 U/mL 未満	1 U/mL 以下

※ その他の検査内容に変更はございません。


《変更理由》 検査体制の見直し

《相 関 図》


● HBV-DNA 定量

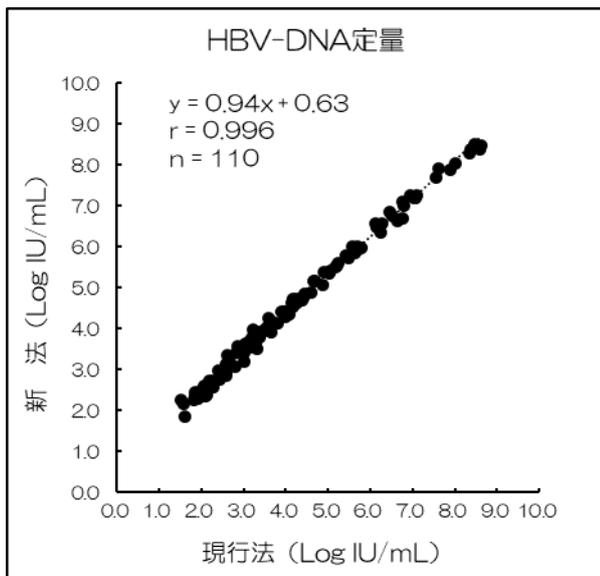

● HCV-RNA 定量

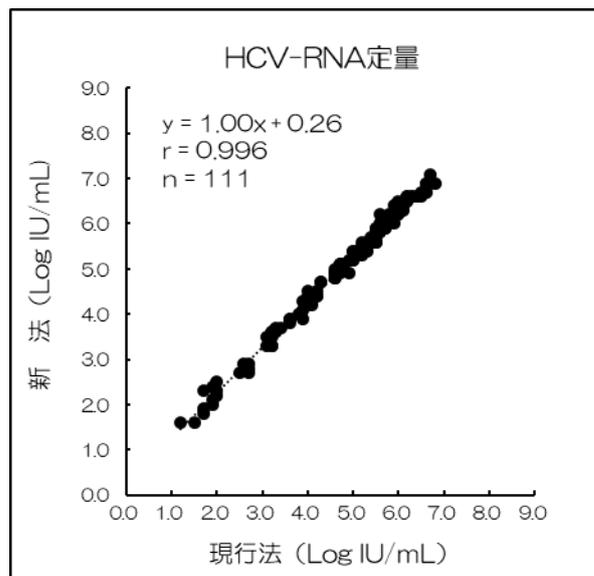

● CA125

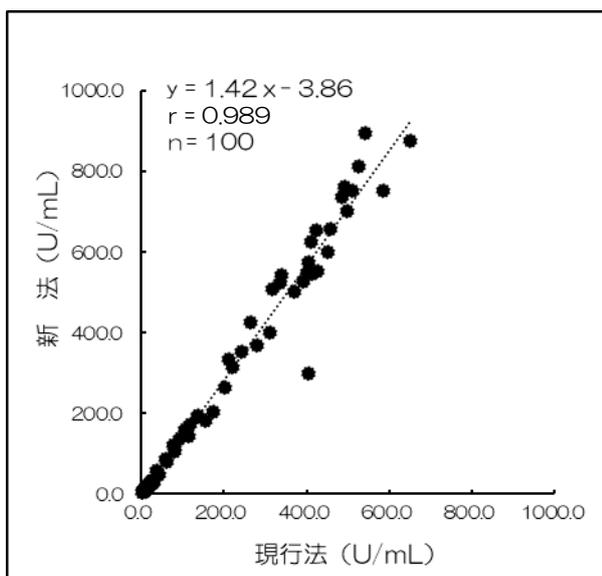

(低濃度領域)

